

小动物活体实时成像仪 Biospace OPTIMA 开关机流程

1. 开机：


① 开电脑主机（电脑密码：bios123）

完全进入电脑桌面后，观察仪器副屏是否点亮。已点亮可跳过步骤②

② 成像仪开机：长按设备正面面板按钮 3s 开机 → 开机 **3-5 min** 后

③ 打开电脑软件

④ 观察仪器副屏 **等待 Tube Temp 降温至 -28°C** 后，开始图像采集

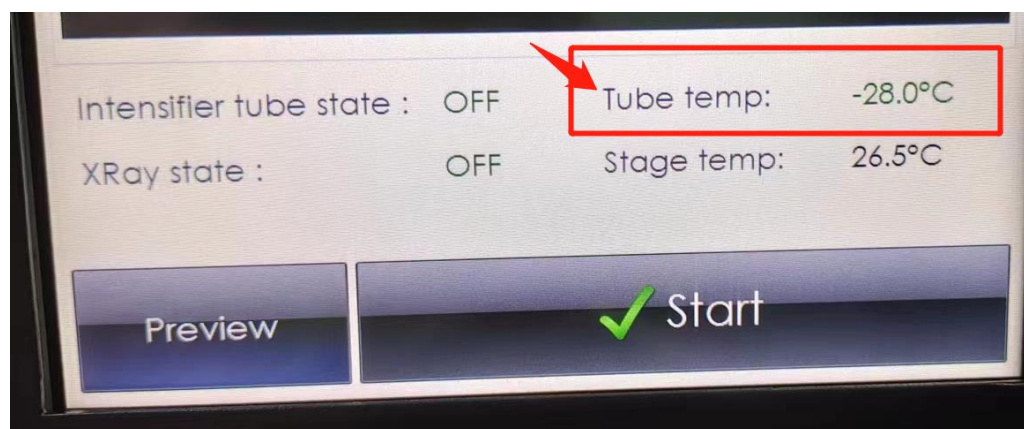

2. 关机

2.1 麻醉机关机：每一次实验结束时，请务必确认麻醉仪关闭。

★要检查 5 个部件都要关!! ①蒸发罐指数归零；②流量计 O₂ 开关关闭；③关闭麻醉气泵；④关闭气体回收器；⑤关闭麻醉仪插座总开关。

2.2 成像仪关机：

- 确认 48 小时内无人使用后可严格按照以下顺序关机

①关闭电脑软件 → ②关闭仪器（短按设备正面面板按钮关机，触屏黑屏） → ③关电脑主机。★一定要先关软件再关仪器!!!

- 48 小时内有人继续使用（当天有人使用可以不用关电脑主机）

关闭电脑软件 → 关电脑主机，★不关仪器。